

仕 様 書

1 品 名 ソリッドパック熱電対（2種）

2 数 量 35 本

3 規 格

下記の仕様を満たす「株式会社チノ一製 ソリッドパック熱電対」または、同等品を選定すること。

※仕様・形状については別図 1～2 を参照すること。

	メーカー	品名	商品番号	仕様		数量	参照図面
1	株式会社 チノ一	ソリッド パック 熱電対	-	保護管	材質：SUS310S 外径：φ 22mm 首下長：900mm 充填材：高純度酸化マグネシウム	25 本	別図 1
				エレメント	素線：K 許容差：JIS クラス 2 常用限度：1, 200°C 素線径：φ 3.2mm 測温接点：非接地形		
2	株式会社 チノ一	ソリッド パック 熱電対	1NKS22A	保護管	材質：SUS310S 外径：φ 22mm 首下長：1, 000mm 充填材：高純度酸化マグネシウム	10 本	別図 2
				エレメント	素線：K 許容差：JIS クラス 2 常用限度：1, 200°C 素線径：φ 3.2mm 測温接点：非接地形		

※同等品を選定する場合は、上表に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」、「清掃工場での使用実績（様式任意、納入年月・納入工場名・使用箇所を明記）」を、令和 8 年 1 月 16 日（金）正午までに購入所管課へ提出し、承認を得た上で、契約課に見積書を提出すること。

4 納入期限 令和 8 年 3 月 27 日（金）

5 納入場所 静岡市葵区南沼上 1224 番地 沼上清掃工場

6 その他

- (1) 納入の際は、事前に購入所管課担当者に連絡をすること。
- (2) 梱包に要した段ボール箱・ビニール等を持ち帰ること。
- (3) 不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

7 購入所管課 静岡市環境局廃棄物処理課 沼上清掃工場

担当 村田 電話 054-262-4015

別 図 1

品名	備考
ソリッドパック熱電対	焼却炉及びガス混合室内 温度計測用

保護管


材質	SUS310S
外径	$\phi 22\text{mm}$
L	900mm

エレメント

素線	K
許容差	JISクラス2
常用限度	1,200°C
素線径	$\phi 3.2\text{mm}$
測温接点	非接地形

保護管内部充填材

材質	高純度酸化マグネシウム
----	-------------

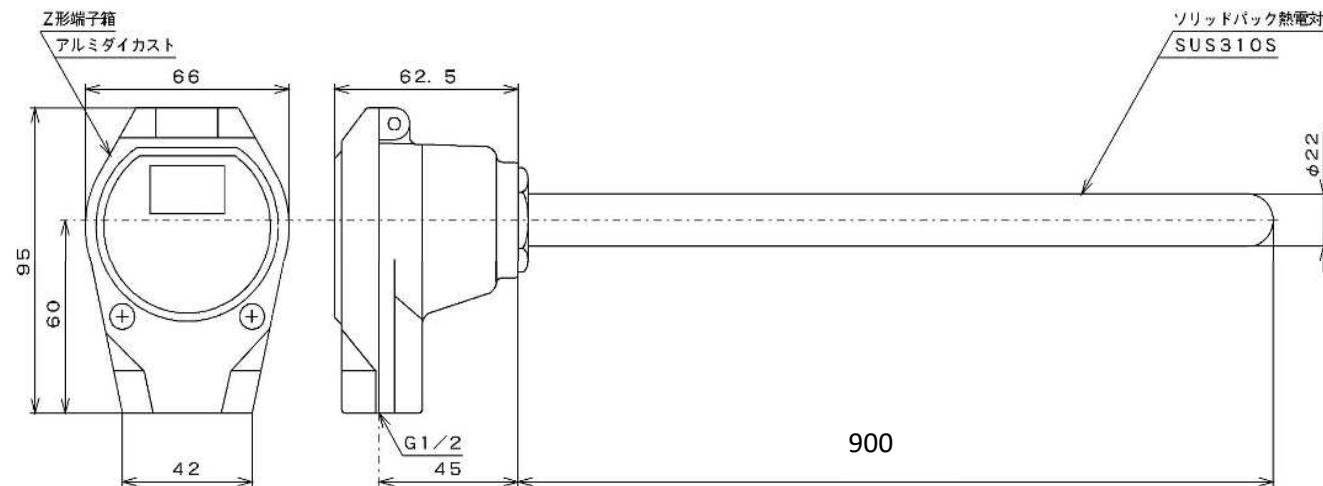

・図はイメージです。

・保護管内部充填材の高純度酸化マグネシウムは必須とします。

別 図 2

品名	備考
ソリッドパック熱電対	焼却炉及びガス混合室内 温度計測用

保護管


材質	SUS310S
外径	$\phi 22\text{mm}$
L	1,000mm

エレメント

素線	K
許容差	JISクラス2
常用限度	1,200°C
素線径	$\phi 3.2\text{mm}$
測温接点	非接地形

保護管内部充填材

材質	高純度酸化マグネシウム
----	-------------

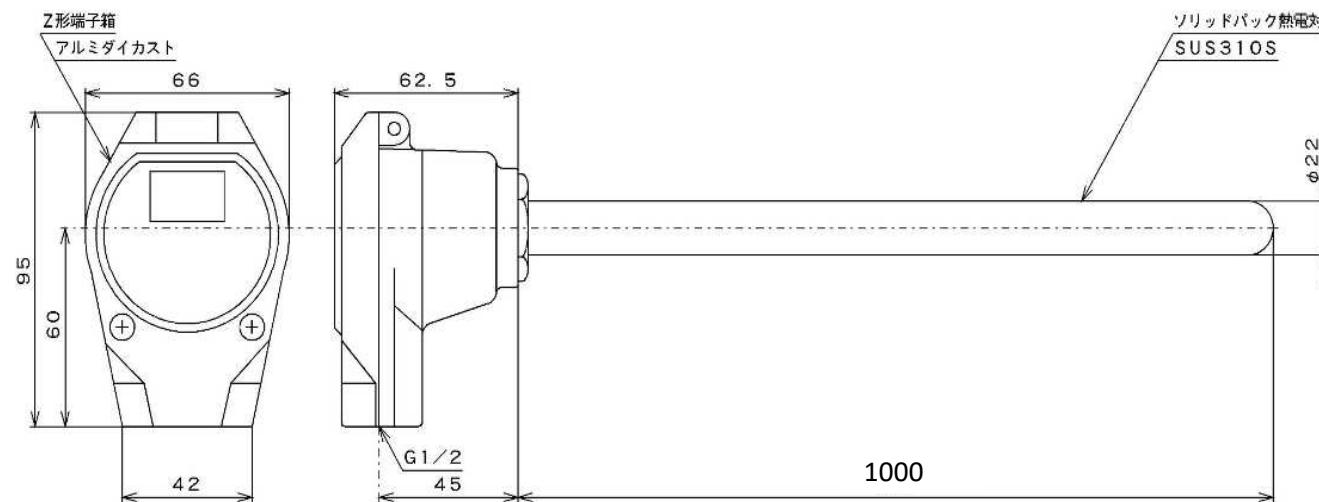

・図はイメージです。

・保護管内部充填材の高純度酸化マグネシウムは必須とします。

見 積 書

拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額									

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

ソリッドパック熱電対（2種）

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先) 静岡市長