


VII 資 料

- 1 静岡市上下水道局組織機構
- 2 水質試験センター平面図
- 3 主要分析機器一覧表


1 静岡市上下水道局組織機構

(令和 7 年 4 月 1 日現在)

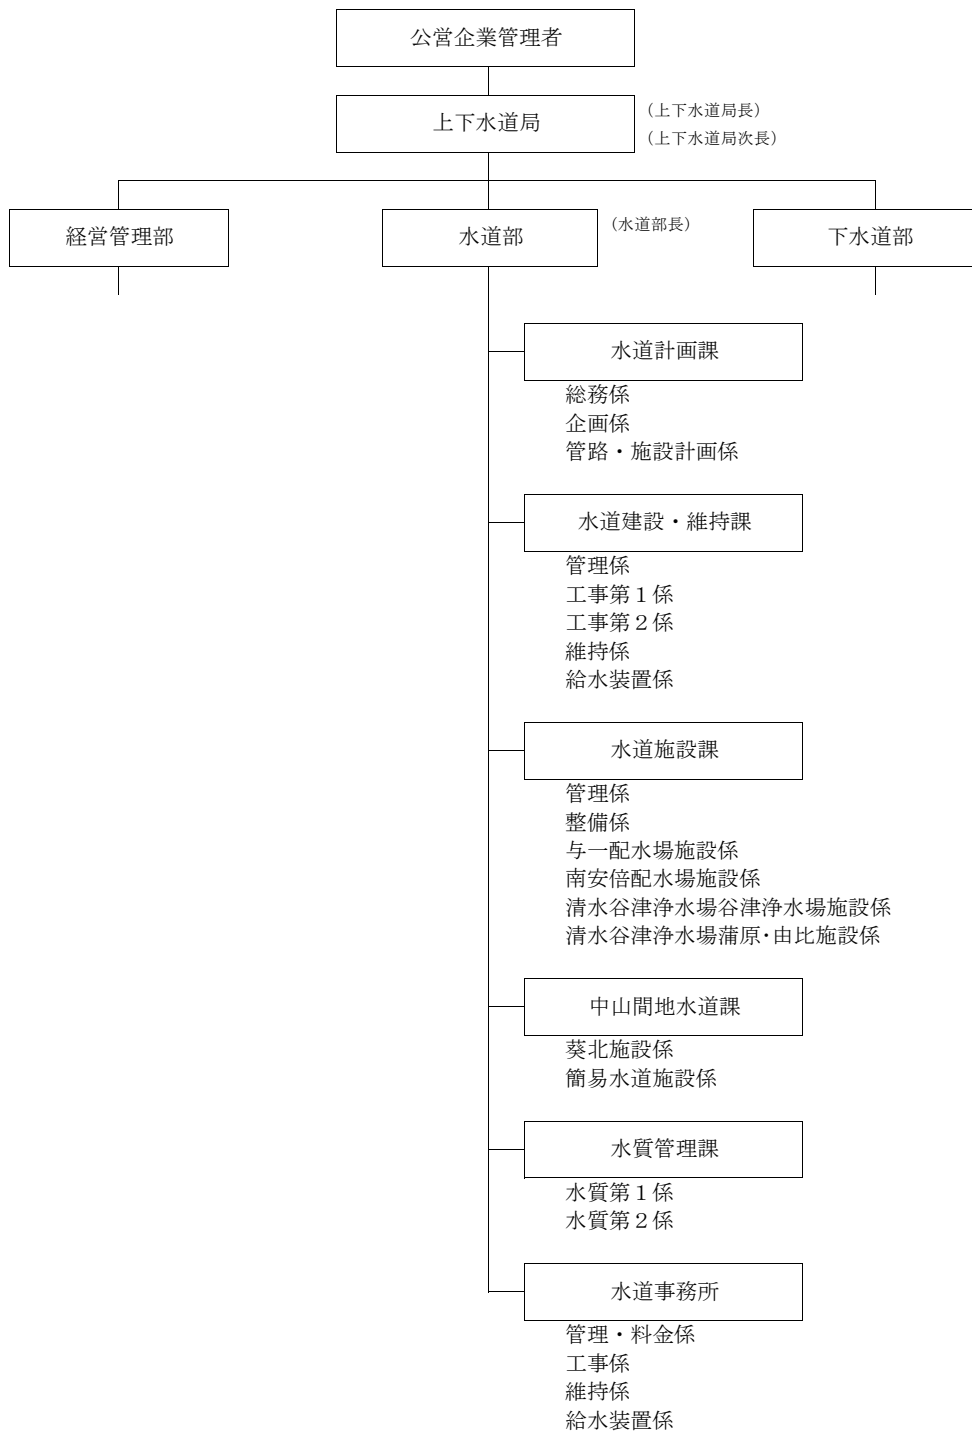


2 水質試験センター平面図

(1 階)

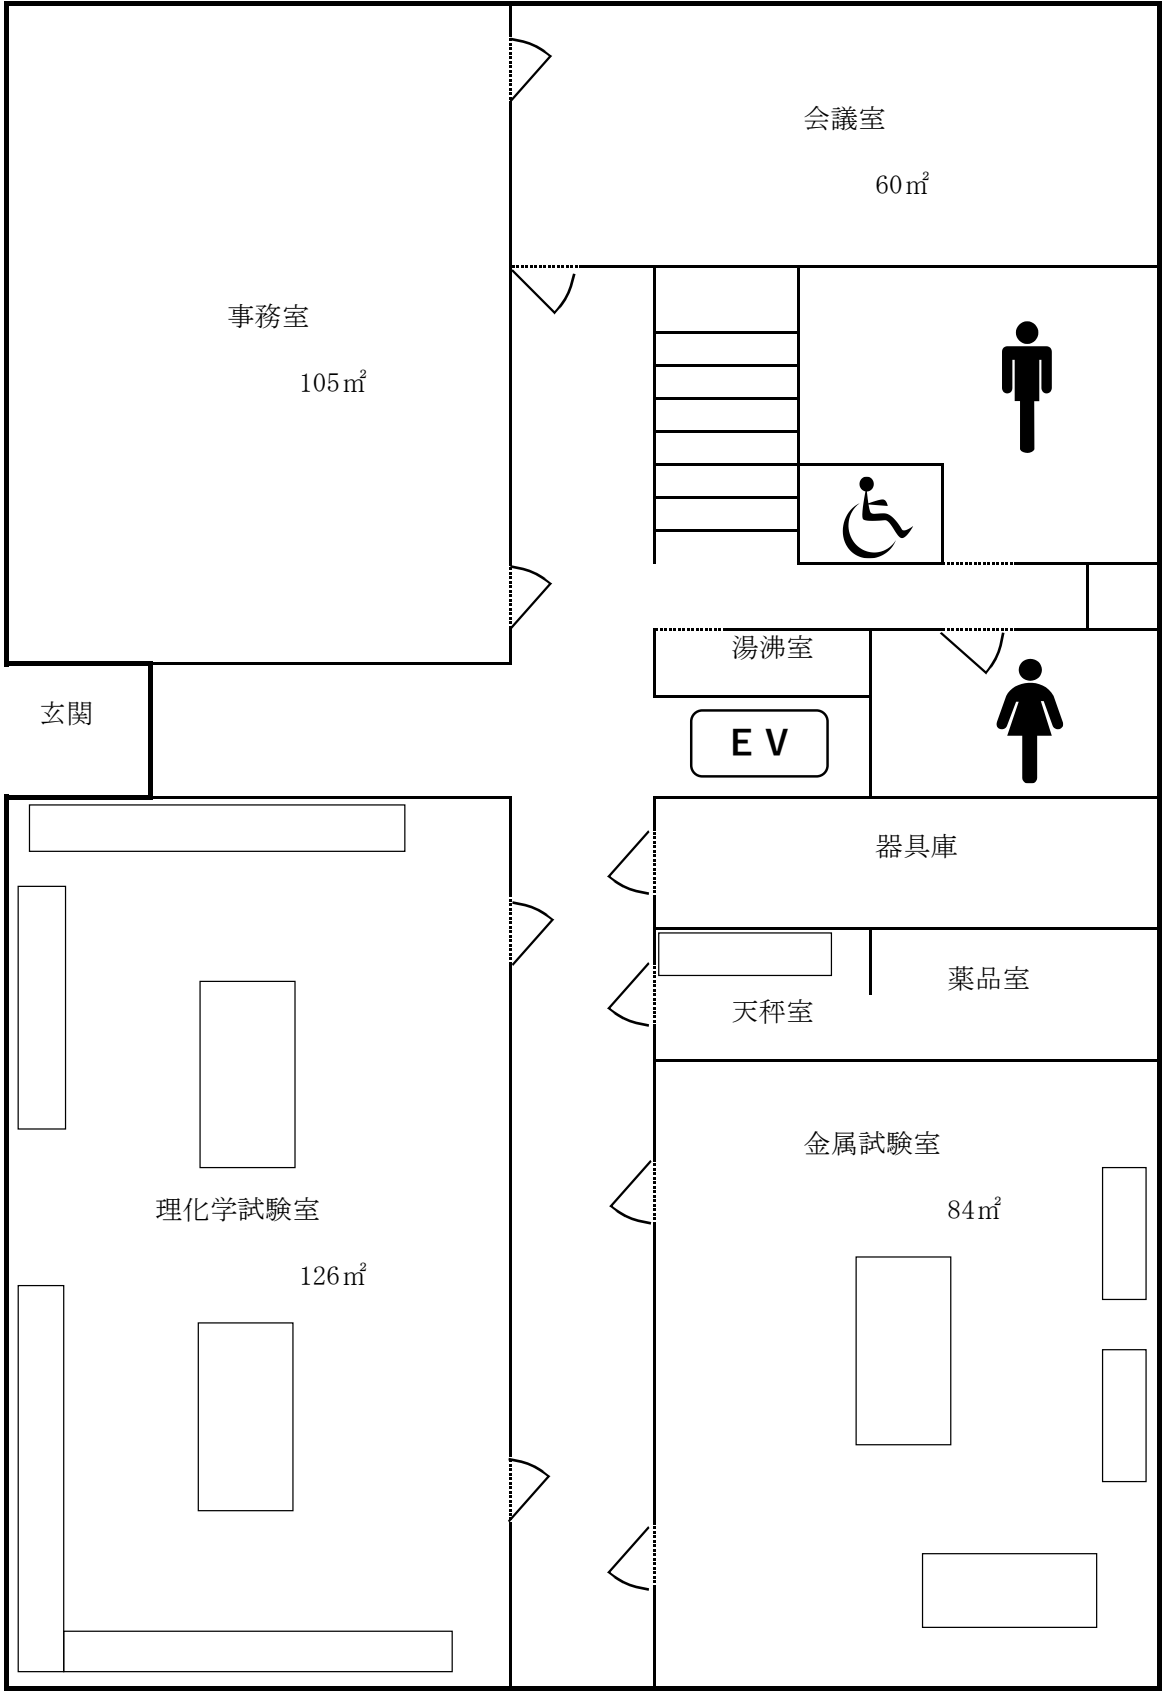

1 階床面積 640.13m²

(2階)

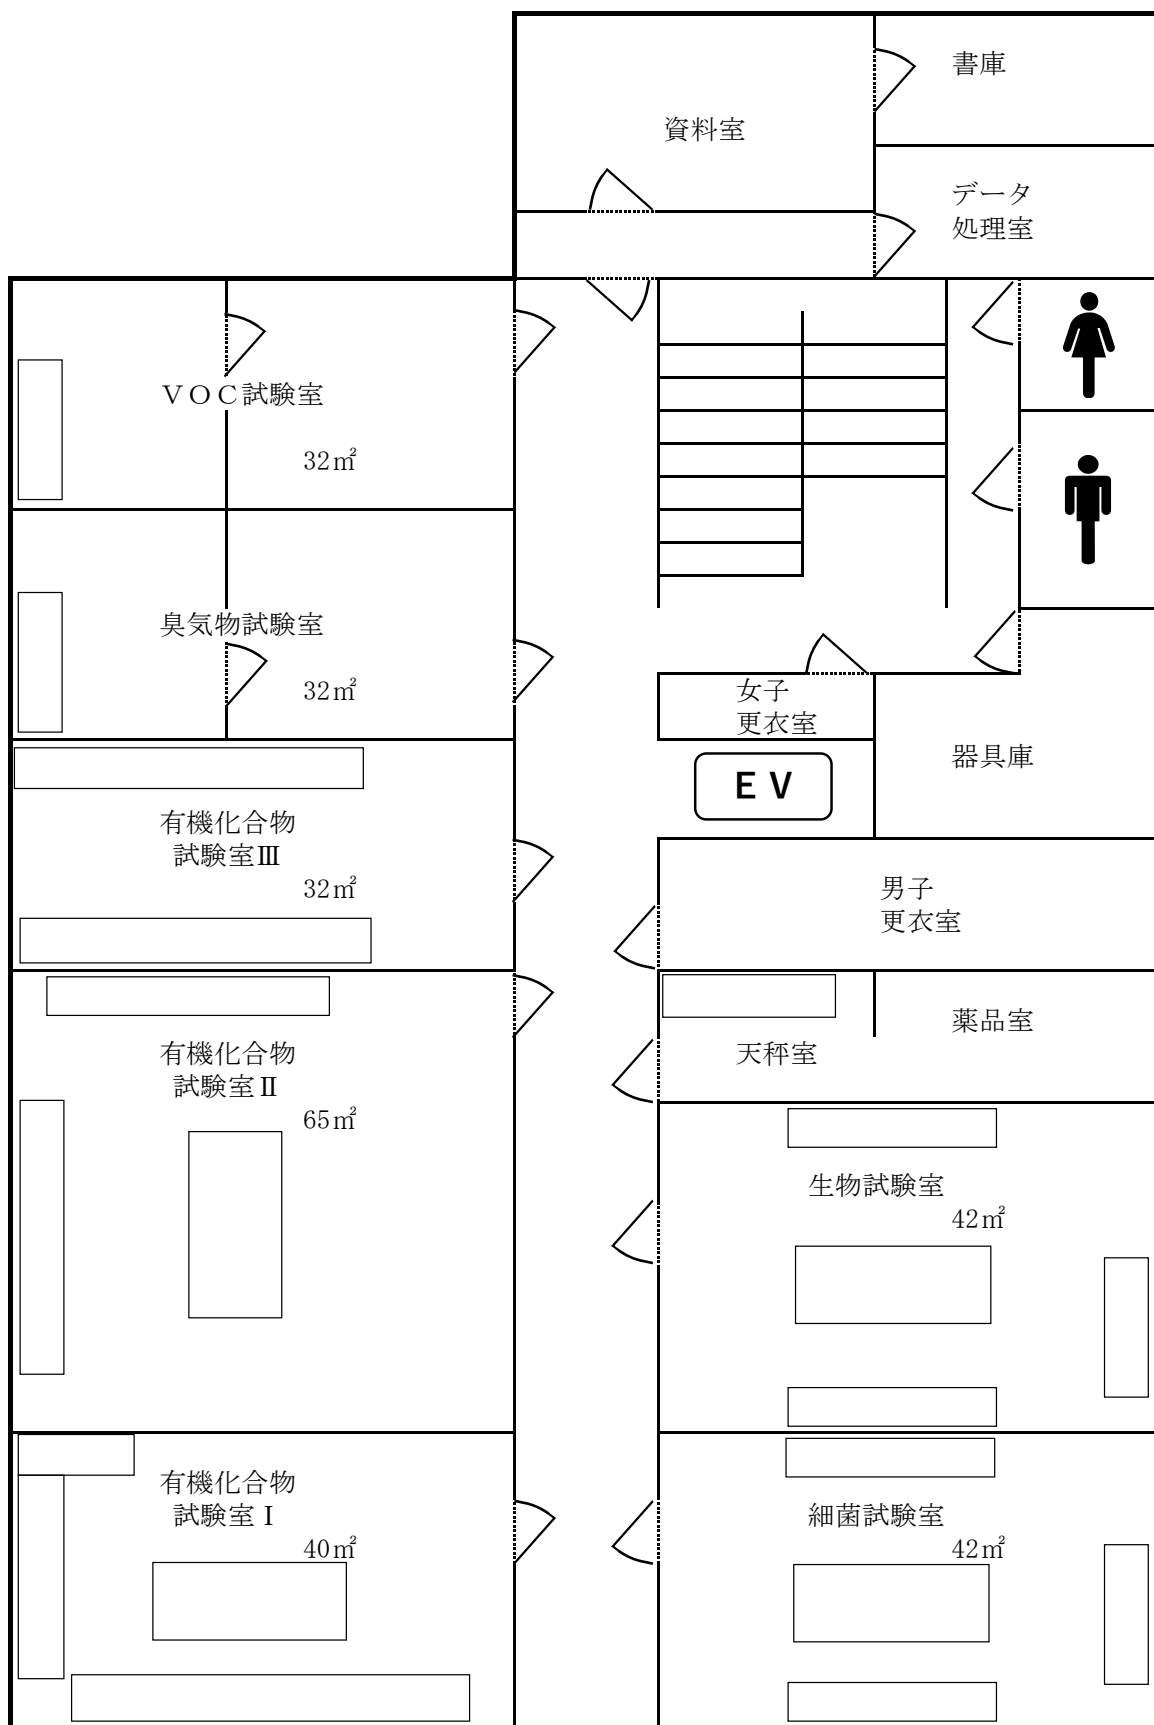

2階床面積 602.63m²

3 主要分析機器一覧表

設置場所		名称	メーカー	型式	検査項目
1階	理化学	イオンクロマトグラフ	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Dionex Integrion	陽イオン類
		イオンクロマトグラフ	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Dionex Integrion,PCM-520	陰イオン類
		イオンクロマトグラフ	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Dionex Integrion RFIC,PCM-530	シアン
		色度・濁度計	日本電色工業	Water Analyzer WA6000,AT48	色度、濁度
		p Hメータ	東亜ディーケーケー	HM-42X	pH値
		全有機炭素計	島津製作所	TOC-L CSH	有機物
		分光光度計	日本分光	V-760	非イオン界面活性剤
		固相抽出装置	ジエールサイエンス	アクアローダーⅢ SPL798	非イオン界面活性剤
	金属	誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレントテクノロジー	7800 ICP-MS	金属類
		水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-4500	水銀
天秤	電子天秤	ザルトリウス	MCA225P	蒸発残留物	
2階	有機Ⅱ	全自動固相抽出装置	ジエールサイエンス	アクアトレース ASPE899	フェノール類
	有機Ⅲ	液体クロマトグラフ質量分析装置	エービー・サイエックス	QTRAP4500	ハロ酢酸 フェノール類 陰イオン界面活性剤
		ガスクロマトグラフ質量分析装置	アジレントテクノロジー	5977B GC/MSD	ホルムアルデヒド
	臭気物	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析装置	島津製作所	QP-2020NX	臭気物
			ジエールサイエンス	Aqua PT7000	
	V O C	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析装置	島津製作所	QP-2020NX	揮発性有機化合物
ジエールサイエンス			Aqua PT7000		

水 質 年 報

令和 6 年度

発行 静岡市上下水道局水道部水質管理課

〒424-0014 静岡市清水区庵原町 1 5 2 番地の 9

TEL 054-363-6651

FAX 054-363-6688

E-mail: suishitsukanri@city.shizuoka.lg.jp

令和 7 年10月発行